

# PMFT 1000 M



Der PMFT 1000 M testet Atemschutzmasken besser als die Normen EN 149/EN 13274-7, mit zusätzlicher exakter Analyse der Filtermaskeneffizienz für SARS-CoV-2 (Größe ca. 120 nm bis 160 nm). Geprüft wird die photometrische Gesamtpenetration und der Fraktionsabscheidegrad d.h. der Wirkungsgrad über die Partikelgröße bzw. die partikelgrößenabhängige Penetration.

## FUNKTIONSPRINZIP

### PMFT 1000 M FÜR DEN ZUVERLÄSSIGEN DAUERBETRIEB IN DER ROUTINEKONTROLLE FÜR HALBMASKEN


Die Messung der Gesamtpenetration und der Penetration über die Partikelgröße erfolgt mit dem hochpräzisen Aerosolphotometer Promo® LED 2300.

Die Größenverteilung des Testaerosols liegt nach Norm wie folgt:

EN 149


Öl: Mediandurchmesser 290 nm | Geom. Standardabweichung 1,85

Salz: Mediandurchmesser 70 nm | Geom. Standardabweichung 2,5

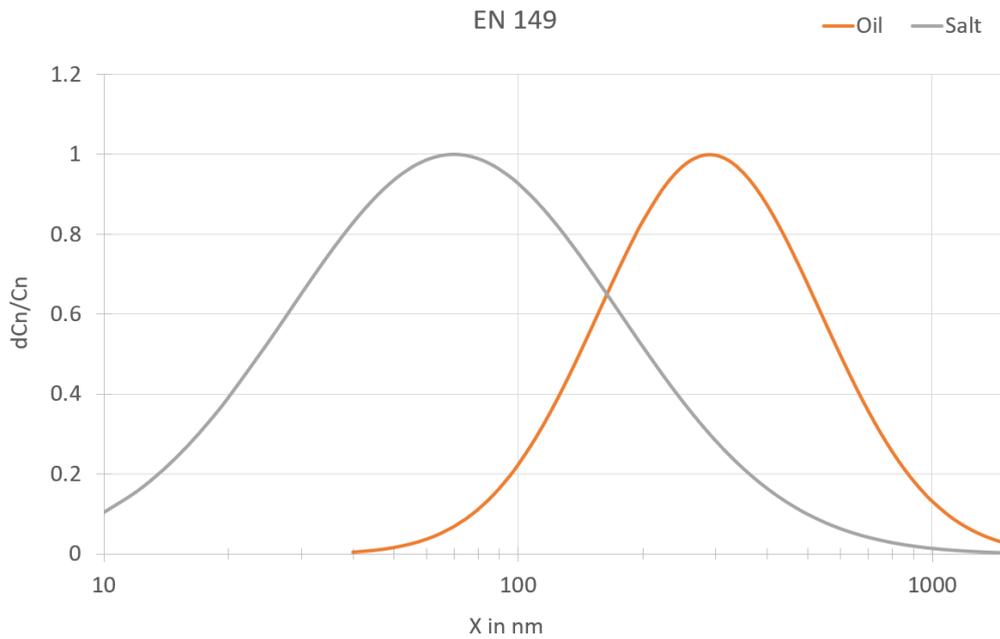


42 CFR 84 / GB 2626


Öl: Mediandurchmesser 200 nm | Geom. Standardabweichung 1,6  
 Salz: Mediandurchmesser 55 nm | Geom. Standardabweichung 1,86

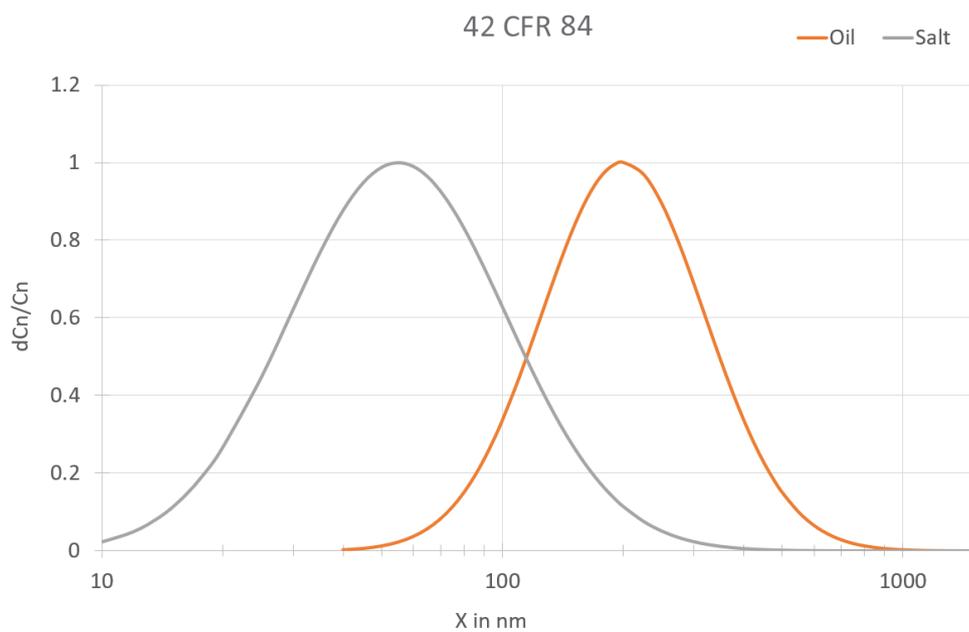

Auf Basis der Messung der Partikelpenetration über die Partikelgröße können mit dem PMFT 1000 M auch die Toleranzen in der Partikelgrößenverteilung nach EN 13274-7 als min. / max. Penetrationswert betrachtet werden. Zudem sind Vergleichswerte zu anderen Herstellern möglich (Option).

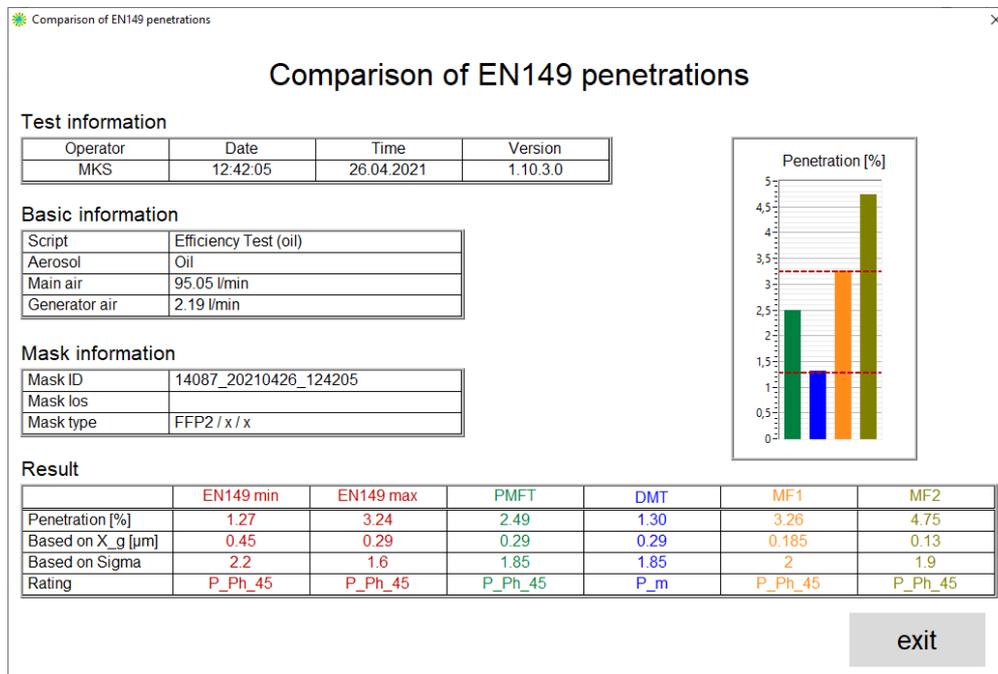

Auch der Vergleich zu anderen Normen (42CFR84/NIOSH) ist mit dem Upgrade KIT 42CFR84 einfach möglich.

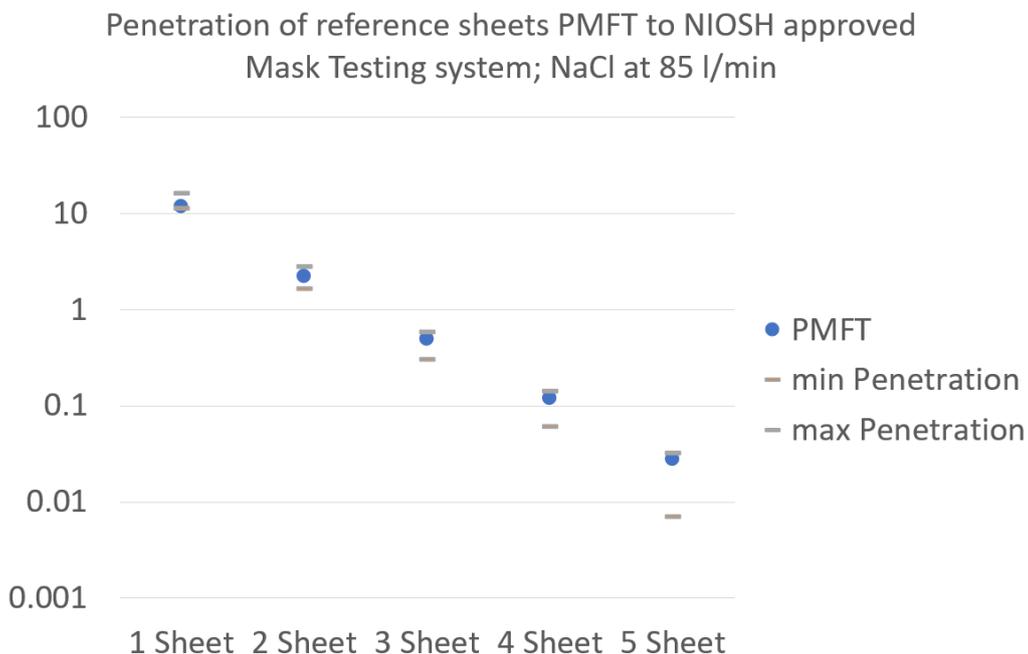

#### Erweiterungen/Zubehör

Der PMFT 1000 M ist mit Aerosolgeneratoren für die Messung der Penetration mit Öl und Salz ausgestattet. Messprozeduren für die schnelle Qualitätskontrolle (Kurztest) oder für die Prüfung nach Norm (Expositionsprüfung) werden vorbereitet mitgeliefert.

Die Bedienung und der automatische Ausdruck des Messergebnisses sind somit auch für ungeübte Nutzer einfach möglich.

## VORTEILE

- Arbeitsweise des Prüfstands besser als EN 149 und EN 13274-7
- Äquivalent zu GB 2626, 42 CFR 84 und ASTM 2299-3 über zusätzliche Softwareoption
- Test von Alltagsmasken nach CWA 17553
- Erfüllt Anforderungen an CCF (Covid Certified Filter) – Qualitätssiegel
- Wird mit zwei Aerosolgeneratoren für NaCl und Öl geliefert
  
- Prüfung der fraktionalen Effizienz, z. B. Effizienz im gesamten Größenbereich von 145 nm bis 5  $\mu\text{m}$
- Genaue Analyse der Filter- und Filtermaskeneffizienz für SARS-CoV-2 (Größe ca. 120 nm bis 160 nm). Effizienzanalyse bei 145 nm
  
- Zukunftssicher: Funktioniert mit jeder Art von Aerosol ohne Anpassungen
- Weitere Messung des Differenzdrucks, z. B. auch bei unterschiedlichen Anströmgeschwindigkeiten zur Simulation des Atemwiderstands
  
- Anströmgeschwindigkeit einstellbar zwischen 1,5 – 70 cm/s
- Produkt mit schneller Qualitätssicherung **und** kontinuierlicher Optimierung in FE (Darstellung der Größenverteilung)
- Individueller Gesichtsmaskenadapter für Ihr Produkt
- Attraktives 2-Jahres-Wartungspaket für die Verfügbarkeit des Prüfstands
- Kann mit Mas Q-Head als Mas-Q-Check betrieben werden

### Die Softwareerweiterung bietet zusätzlich:

- Darstellung der Penetrationsergebnisse des gesamten Toleranzbereiches der Größenverteilung nach EN 13274-7
- Ermöglicht den Vergleich verschiedener Prüfinstitute und Prüfsysteme
- Erleichtert Zertifizierung
- Zeigt breiten Spielraum von Normen. Je nach Prüfbedienung – sprich Partikelgrößenverteilung des Prüfaerosols – kann ein und dieselbe Maske bei der Prüfung sehr gut abschneiden oder auch durchfallen

## TECHNISCHE DATEN

Aerosole	Salze (z. B. NaCl, KCl), Flüssigaerosole (z. B. DEHS), Latexpartikel (PSL)
Testfläche des Mediums	100 cm <sup>2</sup>
Messbereich (Gesamtpenetration)	0,0005 - 100 %
Messbereich (Größe)	0,145 – 40 µm
Volumenstrom	1 – 27 m <sup>3</sup> /h - Druckbetrieb
Elektrischer Anschluss	115 – 230 V, 50/60 Hz
Aufstellungsbedingungen	+10 – +40 °C
Differenzdruckmessung	0 – 1.200 Pa
Anströmgeschwindigkeit	1,5 – 70 cm/s (andere auf Anfrage)
Druckluftversorgung	6 – 8 bar
Verdünnungsfaktor	1 : 27
Testbedingungen nach Norm	+19 – +23 °C
Abmessungen	Ca. 1.800 • 600 • 900 mm (H • B • T)

## ANWENDUNGEN

- Zuverlässiger Dauerbetrieb in der Routinekontrolle für Halbmasken
- Messung der Gesamtpenetration von Atemschutzmasken
- Exakte Analyse von Filtermaskeneffizienz für bspw. Coronavirus
- Kann mit Mas-Q-Head als Mas-Q-Check betrieben werden



Mehr Informationen:  
<https://www.palas.de/product/pmft-1000-m>

	EN 149	EN 13274-7	EN 13274-7	GB 2626	GB 2626	42 CFR 84	42 CFR 84
<b>Aerosol</b>	siehe EN 13274-7	NaCl	PaO	NaCl	PaO/DOP	NaCl	DOP
<b>Durchschnittlicher Durchmesser</b>	siehe EN 13274-7	0,06 – 0,1 $\mu\text{m}$	0,29 – 0,45 $\mu\text{m}$	0,055 – 0,095 $\mu\text{m}$	0,165 – 0,205 $\mu\text{m}$	0,055 – 0,095 $\mu\text{m}$	0,165 – 0,205 $\mu\text{m}$
<b>Standardabweichung</b>	siehe EN 13274-7	2 – 3	1,6 – 2,2	< 1,86 (durch zusätzliche Software-module)	< 1,6 (durch zusätzliche Software-module)	< 1,86 (durch zusätzliche Software-module)	< 1,6 (durch zusätzliche Software-module)
<b>Konzentration</b>	siehe EN 13274-7	4 – 12 $\text{mg}/\text{m}^3$	15 – 25 $\text{mg}/\text{m}^3$	< 200 $\text{mg}/\text{m}^3$	(50 $\text{mg}/\text{m}^3$ ) < 200 $\text{mg}/\text{m}^3$	< 200 $\text{mg}/\text{m}^3$	< 200 $\text{mg}/\text{m}^3$
<b>Entladung</b>	-	-	-	erforderlich	erforderlich	erforderlich	erforderlich
<b>Luftstrom</b>	siehe EN 13274-7	95 l/min	95 l/min	85 $\pm$ 4 l/min	85 $\pm$ 4 l/min	85 $\pm$ 4 l/min	85 $\pm$ 4 l/min
<b>Temperatur</b>	siehe EN 13274-7	22 $\pm$ 3 $^{\circ}\text{C}$	-	25 $\pm$ 5 $^{\circ}\text{C}$	25 $\pm$ 5 $^{\circ}\text{C}$	25 $\pm$ 5 $^{\circ}\text{C}$	25 $\pm$ 5 $^{\circ}\text{C}$
<b>Rel. Luftfeuchtigkeit</b>	see EN 13274-7	< 40 %	-	20 – 40 % (durch Druckluft)	-	20 – 40 % (durch Druckluft)	20 – 40 % (durch Druckluft)
<b>Messgerät</b>	see EN 13274-7	Natrium-Flammenphotometer	Streulichtphotometer	Partikeldetektor	Partikeldetektor	Streulichtphotometer	Streulichtphotometer
<b>Messzeit</b>	siehe EN 13274-7	30 s	30 s	niedrigster Wirkungsgrad beim Laden	niedrigster Wirkungsgrad beim Laden	niedrigster Wirkungsgrad beim Laden	niedrigster Wirkungsgrad beim Laden
<b>Pausenzeit</b>	see EN 13274-7	180 s	180 s	niedrigster Wirkungsgrad beim Laden	niedrigster Wirkungsgrad beim Laden	niedrigster Wirkungsgrad beim Laden	niedrigster Wirkungsgrad beim Laden
<b>Exposition</b>	120 mg	120 mg	120 mg	200 $\pm$ 5 mg	200 $\pm$ 5 mg	200 $\pm$ 5 mg	200 $\pm$ 5 mg
<b>PMFT-Bemerkungen</b>	O.K.	O.K.	O.K.	O.K. mit Upgrade KIT	O.K. mit Upgrade KIT	O.K. mit Upgrade KIT	O.K. mit Upgrade KIT

Tabelle 2: Übersicht der Normen zur Prüfung des Durchlasses von Atemschutzmasken