PMFT 1000





Der PMFT 1000 testet Atemschutzmasken besser als die Normen EN 149/EN 13274-7 mit zusätzlicher exakter Analyse der Filtermaskeneffizienz für SARS-CoV-2 (Größe ca. 120 nm bis 160 nm). Geprüft wird die photometrische Gesamtpenetration und der Fraktionsabscheidegrad d.h. der Wirkungsgrad über die Partikelgröße bzw. die partikelgrößenabhängige Penetration.

FUNKTIONSPRINZIP


PMFT 1000 FÜR DIE ENTWICKLUNG UND PRODUKTIONSÜBERWACHUNG VON HALBMASKEN

Die Messung der Gesamtpenetration und der Penetration über die Partikelgröße erfolgt mit dem hochpräzisen Aerosolphotometer Promo® 1000.

Die Größenverteilung des Testaerosols liegt nach Norm wie folgt:


EN 149





Öl: Mediandurchmesser 290 nm | Geom. Standardabweichung 1,85

Salz: Mediandurchmesser 70 nm | Geom. Standardabweichung 2,5 42 CFR 84 / GB 2626




Öl: Mediandurchmesser 200 nm | Geom. Standardabweichung 1,6


Salz: Mediandurchmesser 55 nm | Geom. Standardabweichung 1,86



Auf Basis der Messung der Partikelpenetration über die Partikelgröße können mit dem PMFT 1000 auch die Toleranzen in der Partikelgrößenverteilung nach EN 13274-7 als min / max. Penetrationswert betrachtet werden. Zudem sind Vergleichswerte zu anderen Herstellern möglich (Option).

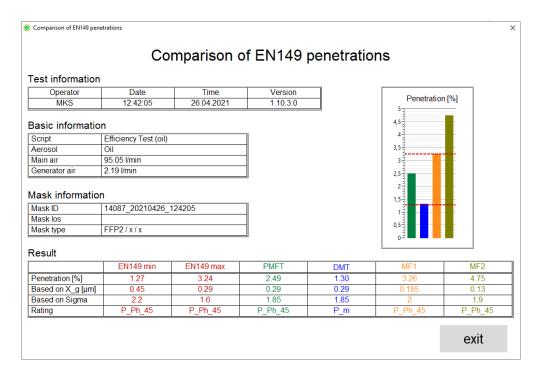

Auch der Vergleich zu anderen Normen (42CFR84/NIOSH) ist mit dem Upgrade KIT 42CFR84 einfach möglich.



PMFT 1000



| | EN 149 | | EN 13274-7 | EN 13274-7 | GB 2626 | GB 2626 | 42 CFR 84 | 42 CFR 84 |
|-----------------------------|------------------------------|----|---------------------------|------------------------------|--|---|--|---|
| Aerosol | siehe 13274-7 | EN | NaCl | PaO | NaCl | PaO/DOP | NaCl | DOP |
| Durchschnittlic | he sirehe | EN | 0,06 – 0,1 μm | 0,29 - 0,45 | 0,055 – 0,095 | 0,165 – 0,205 | 0,055 – 0,095 | 0,165 – 0,205 |
| Durchmesser | 13274-7 | | | μm | μ m | μ m | μ m | μ m |
| Standardabwei | c hsiælg e 13274-7 | EN | 2-3 | 1,6 – 2,2 | < 1,86 (durch zusätzliche Softwaremo- dule) | < 1,6 (durch zusätzliche Softwaremo- dule) | < 1,86 (durch zusätzliche Softwaremo- dule) | < 1,6 (durch zusätzliche Softwaremo- dule) |
| Konzentration | siehe 13274-7 | EN | 4 –12 mg/m³ | 15 – 25 mg/m ³ | < 200 mg/m ³ | (50 mg/m³) < 200 mg/m³ | < 200 mg/m ³ | < 200 mg/m ³ |
| Entladung | - | | - | - | erforderlich | erforderlich | erforderlich | erforderlich |
| Luftstrom | siehe 13274-7 | EN | 95 l/min | 95 l/min | 85 ± 4 l/min | 85 ± 4 l/min | 85 ± 4 l/min | 85 ± 4 l/min |
| Temperatur | siehe 13274-7 | EN | 22 ± 3 °C | - | 25 ± 5 °C | 25 ± 5 °C | 25 ± 5 °C | 25 ± 5 °C |
| Rel. Luft- feuchttigkeit | see 13274-7 | EN | < 40 % | - | 20 – 40 % (durch Druck- luft) | - | 20 – 40 % (durch Druck- luft) | 20 – 40 % (durch Druck- luft) |
| Messgerät | see 13274-7 | EN | Natrium- Flammenphotor | | n ehar tikeldetektor | Partikeldetektor | Streulichtphotor | m &ter eulichtphotometer |
| Messzeit | siehe 13274-7 | EN | 30 s | 30 s | niedrigster Wirkungsgrad beim Laden | niedrigster Wirkungsgrad beim Laden | niedrigster Wirkungsgrad beim Laden | niedrigster Wirkungsgrad beim Laden |
| Pausenzeit | see 13274-7 | EN | 180 s | 180 s | niedrigster Wirkungsgrad beim Laden | niedrigster Wirkungsgrad beim Laden | niedrigster Wirkungsgrad beim Laden | niedrigster Wirkungsgrad beim Laden |
| Exposition | 120 mg | | 120 mg | 120 mg | 200 ± 5 mg | 200 ± 5 mg | 200 ± 5 mg | 200 ± 5 mg |
| PMFT- Bemerkungen | O.K. | | O.K. | O.K. | O.K. mit Up- grade KIT | O.K. mit Up- grade KIT | O.K. mit Up- grade KIT | O.K. mit Up- grade KIT |

Tabelle 2: Übersicht der Normen zur Prüfung des Durchlasses von Atemschutzmasken

Erweiterungen/Zubehör

Aerosogeneratoren

Der PMFT 1000 ist mit Aerosolgeneratoren für die Messung der Penetration mit Öl und Salz ausgestattet. Messprozeduren für die schnelle Qualitätskontrolle (Kurztest) oder für die Prüfung nach Norm (Expositionsprüfung) werden vorbereitet mitgeliefert.

Die Bedienung und der automatische Ausdruck des Messergebnisses sind somit auch für ungeübte Nutzer einfach möglich.

Softwareerweiterung

- Darstellung der Penetrationsergebnisse des gesamten Toleranzbereiches der Größenverteilung nach EN
- Ermöglicht den Vergleich verschiedener Prüfinstitute und Prüfsysteme
- Erleichtert Zertifizierung
- Zeigt breiten Spielraum von Normen. Je nach Prüfbedienung sprich Partikelgrößenverteilung des Prüfaerosols – kann ein und dieselbe Maske bei der Prüfung sehr gut abschneiden oder auch durchfallen

Stand: 03.10.2025 **PMFT 1000** Seite 4 von 7



VORTEILE

- Arbeitsweise des Prüfstands besser als EN 149 und EN 13274-7, äquivalent zu GB 2626, 42 CFR 84 und ASTM 2299-3 über zusätzliche Softwareoption
- Test von Alltagsmasken nach CWA 17553
- Wird mit zwei Aerosolgeneratoren für NaCl und Öl geliefert
- Prüfung der fraktionalen Effizienz, z. B. Effizienz im gesamten Größenbereich von 100 nm bis 3 μ m
- Genaue Analyse der Filter- und Filtermaskeneffizienz für SARS-CoV-2 (Größe ca. 120 nm bis 160 nm) im Größenbereich zwischen 100 nm und 180 nm haben wir acht Größenkanäle
- Zukunftssicher: Funktioniert mit jeder Art von Aerosol ohne Anpassungen
- Weitere Messung des Differenzdrucks, z. B. auch bei unterschiedlichen Anströmgeschwindigkeiten zur Simulation der Messung des Atemwiderstands
- Anströmgeschwindigkeit einstellbar zwischen 1,5 70 cm/s
- Produkt zur schnellen Qualitätssicherung **und** kontinuierlichen Optimierung in F&E (Darstellung der Größenverteilung)
- Individueller Gesichtsmaskenadapter für Ihr Produkt

NORMEN UND ZERTIFIKATE

CCF (Covid Certified Filter), EN 149, EN 13274-7, GB 2626, 42 CFR 84



TECHNISCHE DATEN

| Aerosole | Salze (z.B. NaCl, KCl), Flüssigaerosole (z.B. DEHS), Latexpartikel (PSL) |
|---------------------------------|--|
| Testfläche des Mediums | 100 cm ² |
| Messbereich (Gesamtpenetration) | 0,0005 – 100 % |
| | |
| Messbereich (Größe) | 0,12 – 40 μm |
| Volumenstrom | $1 - 27 \text{ m}^3/\text{h}$ - Druckbetrieb |
| Elektrischer Anschluss | 115 – 230 V, 50/60 Hz |
| Aufstellungsbedingungen | +10 – +40 °C |
| Differenzdruckmessung | 0 – 1.200 Pa |
| Anströmgeschwindigkeit | 1,5 – 70 cm/s (andere auf Anfrage) |
| Druckluftversorgung | 6 – 8 bar |
| Verdünnungsfaktor | 1:27 / 1:700 |
| Testbedingungen nach Norm | +19 − +23 °C |
| Abmessungen | Ca. 1.800 • 600 • 900 mm (H • B • T) |



ANWENDUNGEN

- Entwicklung und Produktionsüberwachung von Halbmasken
- Messung der Gesamtpenetration von Atemschutzmasken
- Exakte Analyse von Filtermaskeneffizienz für bspw. Coronavirus



Mehr Informationen: https://www.palas.de/product/pmft-1000